drive MEDQUIP

gentlefeed 2

EN **Duo Electric Breast Pump**

Instructions & Assembly for Gentlefeed 2

ES **Doble Bomba de Pecho Eléctrico**

Instrucciones y Montaje Para el Gentlefeed 2

MQ9100

EN Congratulations

Congratulations on your new Drive Medical Duo Electric Breast Pump! The Drive Medical Duo Electric Breast Pump is perfect for many occasions.

- Collecting breast milk while you're away from your baby
  - for example: when you're at work
- Relieving engorgement
  - for example: when your baby's feeding habits change because they're eating more solids
- Maintaining your milk supply if you have to temporarily stop breast feeding
  - for example: to express unsuitable milk while you are undergoing medical treatment

The Drive Medical Duo Electric Breast Pump provides many of the features busy moms love.

- 3 cycles of expressions to mimic baby's nursing patterns.
  - Reflex Expression - Lach on & Rooting habit
  - Swift Expression - Fast but shallow swallowing habit
  - Natural Expression - Steady and strong swallowing pattern
- Milk back-flow protection
- Quiet motor for discretion
- Small and lightweight
- 2 power options to fit your needs
  - AC/DC Adapter
  - 4 AA Alkaline batteries (not included)
- Convert to Manual Pump in seconds (Parts included)

Indication for Use

The Drive Medical Duo Electric Breast Pump is a personal use, electrically powered device used to express milk from the breasts of lactating women. This device is not intended for hospital use.

Table of Contents

Congratulations 0
Indication for Use 0
Important Safeguards 3
- DANGER 3
- CAUTION 3
- WARNING 3

Parts Guide 5
- Electrical Pump Main Unit 6
- LCD Screen Guide 6
- Expression Collection Combo Kit 7

How to Assemble the Expression Collection Kit 8
How to Assemble Electric-pump Diaphragm Kit 11
How to Assemble Expression Collection Combo Kit 12
Power Options 14
- Using your AC/DC Adapter (included) 14
- Using 4 AA Alkaline Batteries ((Batteries not included) 15
- Install the Batteries (AA Alkaline) 16

Pumping Instructions 18
Suction Level 23
M Button 24
Setting the Time 25
- How to Adjust the Clock 25

Alarm Clock Mode 27
- How to Adjust the Alarm 27

Cleaning Instructions 29
- Sanitize Prior to First Use 29
- Before Each Use 29
- General Cleaning Instructions 29

- Tubing Cleaning Instructions 30

Breastmilk Storage Guidelines 31
- Important Notes 31

Tips 33
- Pumping Tips 33
- Battery Storage 34
- Breastfeeding Tips 34

Troubleshooting 35
- Interruption of Electrical Service 35
- Radio Frequency Energy 35
- Decreased Suction 35
- Breastmilk Buildup in the Breastshield Body 36
- Where to get Replacement Parts 36

Technical Data 37
- Power Requirements 37

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide 38
- Parts Guide 38
- How to Assemble the Expression Collection Combo Kit 39
- How to Assemble the Manual-Pump Diaphragm Kit 41
- Using the Manual Pump 43
- Troubleshooting 44

Warranty 45

Important Safeguards

The Drive Medical Duo Electric Breast Pump is designed for a single user and should never be shared or resold; doing so will void the warranty.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: To reduce the risk of electrocution:
- Always unplug this product immediately after using.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store this product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an electrical product that has fallen into water. Unplug immediately.

CAUTION:
- Do not use this product for any other purpose than as indicated in the Instructions & Assembly.
- Make sure all the parts are assembled correctly before operating.
- Stop using the breast pump immediately if your breasts or nipples experience any discomfort.
- Please wash hands before using this product.
- Keep this product out of reach of babies and children.
- Do not drop or hit the product to avoid damage.
- Do not touch the product with bare hands right after sterilizing by boiling water to avoid scalds and burns.
- Do not over-boil to avoid premature aging of the product materials.

WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- This product should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this product is used near children or invalids.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments or parts not recommended by Drive Medical.
- Do not operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped in water.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use while sleeping or drowsy.
- Do not drop or insert any object into any opening or tubing.
- Do not use outdoors with the AC/DC Adapter or operate where aerosol spray products are being used, or where oxygen is being administered.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
along with your receipt for future reference.

Important Safeguards (Continued)

- Make sure the voltage of the AC/DC Adapter is compatible with the power source.
- Plug the AC/DC Adapter into the electrical outlet first, then plug the Power Cord into your Drive Medical Duo Electric Breast
- Drive Medical has provided an AC/DC Adapter with this device. Using any other AC/DC Adapter not approved by the manufacturer voids the warranty.
- If you are infected with Hepatitis A, Hepatitis B, or have HIV (Human Immunodeficiency Virus): pumping breast milk does not reduce or remove the risk of transmitting the virus to your baby through breast milk.
- Wash the Expression Collection Combo Kit parts before each use.
- Do not operate a motor vehicle while using the Drive Medical Duo Electric Breast Pump.
- Do not attempt to modify the product.

Parts Guide



Breast Pump Main Unit



AC/DC Adapter



Vacuum Tubing with Adapter



Expression Collection Combo Kit (2 Sets)



Bottle Adapter Kit (2 Sets)

Manual Diaphragm Add-On Kit

Parts Guide

● Electric Pump Main Unit

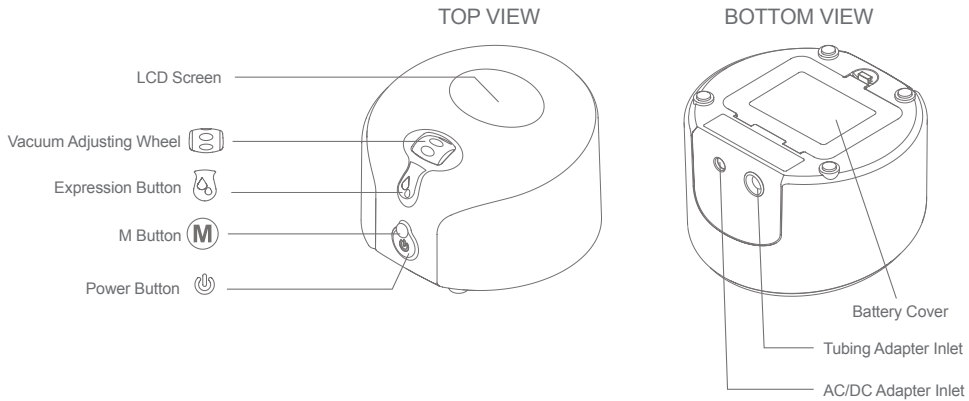

● LCD Screen Guide

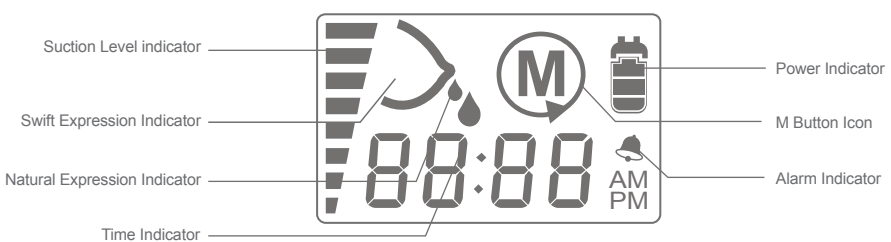

Parts Guide

● **Expression Collection Combo Kit (Duo)**

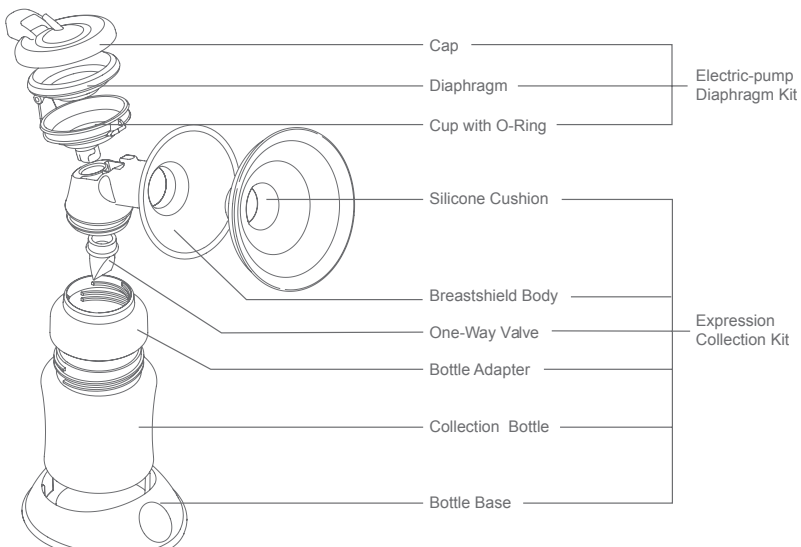

How to Assemble the Expression Collection Kit

Your Drive Medical Duo Electric Breast Pump comes pre-assembled; however, you will need to re-assemble it after each cleaning. (For cleaning instructions, see page 21) Below is a step-by-step guide for assembling the Expression Collection Kit:

1. Hold the "horn" of the Breastshield Body in one hand. Make sure the bottle-thread side opening is facing up.

2. With the thumb and forefinger of the other hand, hold the tip of the One-Way Valve and place the flat circular bottom into the opening. Be sure not to stretch, bend, or twist the tip of the One-Way Valve. Seal all the edges of the flat circular bottom firmly.

   Note: *The One-Way Valve tip does not have to align with anything, as long as all the edges are securely sealed.*



How to Assemble the Expression Collection Kit (Continued)

3. With your thumb and forefinger, gently smooth closed any openings on the tip of the One-Way Valve and shape into a straight line.

Note: *This is critical to the performance of the Pump.*



4. Carefully twist on the Bottle Adapter to the Breastshield Body for a secure fit.

Note: *Be sure not to bump the One-Way Valve when twisting the Breastshield Body & the Bottle Adapter pieces together. If you bump the One-Way Valve, repeat step 3.*

How to Assemble the Expression Collection Kit (Continued)

5. With the Bottle Adapter in one hand, twist on the Collection Bottle for a secure fit.

How to Assemble Electric-pump Diaphragm Kit

1. With the Cup in one hand, place the Silicone Diaphragm in the Cup (matching the shape of the Cup). Press around the edges of the Diaphragm for a secure fit. Make sure the Diaphragm is evenly mounted on the Cup and there is no gap in between them.

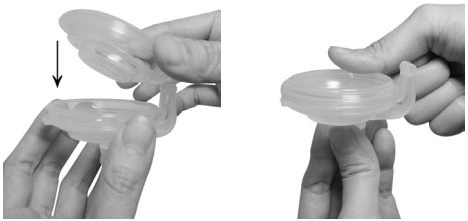

2. Place the Cap on the Cup & Diaphragm. (Be sure to align the hinge and hinge cover.) Press tightly to seal.

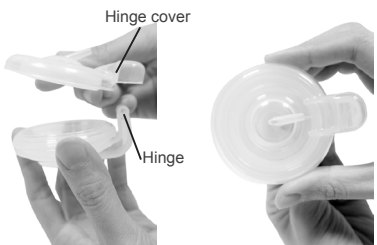

How to Assemble Expression Collection Combo Kit

1. With the O-Ring side down, put the Electric Pump Diaphragm Kit into the top of the Breastshield Body opening. Twist the Electric-Pump Diaphragm Kit clockwise into the Breastshield Body until it locks into place.

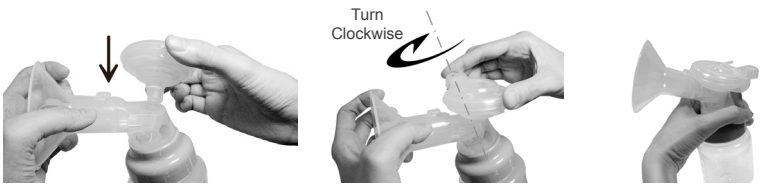

2. With the Breastshield Body in one hand, place the Silicone Cushion in the Breastshield Body (matching the shape of the horn). Secure the lip of the Cushion around the edges of the horn.

Note: *Your Electric Breast Pump will work with or without the Silicone Cushion. Your comfort depends on your preference.*

How to Assemble Expression Collection Combo Kit (Continued)

3. Connect the tubing with the smaller adapter to the Tubing Connector located on the Cap. Push together firmly for a tight seal.

Note: *Make sure there is no moisture in the tubing.*

****To Use As a Single Pump:***
Remove one tube and close the T-connector.

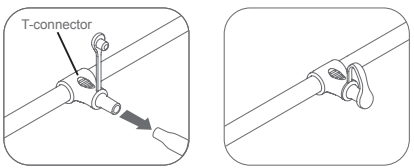

4. Make sure the Tubing Connector is properly inserted into the Tubing Adapter Inlet on the Electric Pump Main Unit.

Power Options

Your Electric Breast Pump may be operated under any of the following power supply modes:

Using your AC/DC Adapter (included):

- Electrical safety can only be achieved when using the AC/DC Adapter which was provided with the Pump. Use of any another Adapters causes concern for the safety of the product and/or the user and voids the warranty.

1. Plug the AC/DC Adapter into an electrical outlet.

2. Attach the Power Cord to the AC/DC Adapter Inlet on the Electric Pump Main Unit.

Power Options (Continued)

Using 4 AA Alkaline batteries:

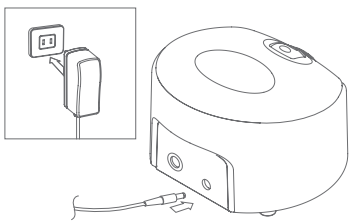

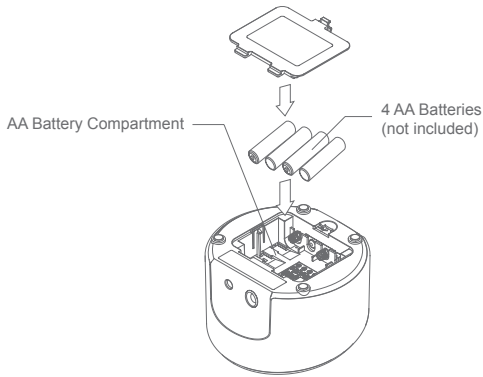

- Always replace all 4 AA Batteries at the same time.
- Remove all batteries from the Electric Pump Base if the Drive Medical Duo Electric Breast Pump is not going to be used for extended periods of time.
- Properly dispose of all batteries, according to regulations for environmental protection and recycling.

Note: *Alkaline Batteries may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do NOT disassemble any battery. Do NOT place batteries near heat source or fire. Dispose of used batteries properly. Do NOT dispose of batteries in fire. Keep away from children.*

Install the Batteries: AA Alkaline

1. Open the Battery Cover.

2. Remove the old batteries if you are replacing them.

Install the Batteries:AA Alkaline (Continued)

3. Insert 4 new AA Alkaline Batteries. Do not mix old and new batteries.

Note: *Make sure the polarity is correct as indicated.*



4. Close the Battery Cover, making sure it "snaps" into place.

Pumping Instructions

1. Hold the Expression Collection Kit to your breast so that your nipple is centered inside the Breastshield.

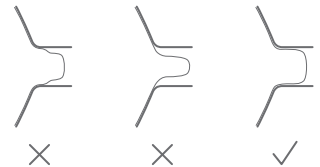

Note: *Please check for correct fitting of the shield.*

2. Press the Power Button ⏻ to begin pumping.

Pumping Instructions (Continued)

3. The LCD Screen shows the time of your last pumping session for a few seconds. The Pump will automatically start from the Reflex Expression for 15 seconds then switch to the Swift Expression automatically.

4. Adjust the suction in the Swift Expression to your comfort level while pumping by rolling the Vacuum Adjusting Wheel up (+) or down (-).

Pumping Instructions (Continued)

5. Depending on your preference, and your baby's sucking habit, you can choose to express your milk in either the Swift Expression or Natural Expression settings. To switch from Swift Expression to Natural Expression, press the Expression Button once.

Expression Button

6. To check which expression setting that you are on, check the LCD display for the Expression Cycle Icon. The breast shape icon indicates that you are at Reflex / Swift Expression setting. The breast shape with milk drops icon indicates that you are at Natural Expression setting.

Reflex/ Swift Expression

Natural Expression

Pumping Instructions (Continued)

7. Adjust the suction in the Natural Expression to the most comfortable and effective level while pumping by rolling the Vacuum Adjusting Wheel up (+) or down (-) .

8. When your pumping session is finished, turn the Pump off by pressing the Power Button.

Pumping Instructions (Continued)

9. After the Pump has been turned off, the LCD Screen will remain on for a few seconds. The display will show the total amount of pumping time, then automatically switch to Standby/Clock mode, or Alarm Clock Mode if the Alarm was turned on.

***Note**: Make sure there is no suction on the nipples before removing the Breastshield. If necessary, break the suction by inserting a finger between the Breastshield and the breast, similar to the way you break away from your baby's suction.*

***Note:** If the* Drive Medical Duo Electric Breast Pump *is left on, but unattended for more than 30 minutes, the Pump will automatically shut-off.*

Suction Level

Whenever you select a Suction Level (in any Expression setting), your Drive Medical Duo Electric Breast Pump remembers it until you change it. This feature becomes useful after you are familiar with this pump. Your Breast Pump retains the memory of your previous pumping level without you having to reset your preferred level each time you pump.

To set your preferred Suction Level:
1. In Reflex / Swift Expression, adjust the Suction Level to the level you find most comfortable by rolling the Vacuum Adjusting Wheel up (+) or down (-).
2. In Natural Expression, adjust the Vacuum Suction Level to the highest effective, yet still comfortable level by rolling the Vacuum Adjusting Wheel up (+) or down (-).

M Button (My Favorite Pattern)

One of the great features of your Drive Medical Duo Electric Breast Pump is the M Button (My Favorite Pattern). You can easily set and recall your personal Expression pattern by pressing the M Button. It is extremely helpful if you usually use Natural Expression setting to express your milk. You do not need to use the M Button if you usually use Swift Expression for your expression.

To set My Favorite Pattern:

1. After a few times of pumping, you will find that your let down time is about the same in every pumping session.
2. Start pumping as you normally do. Your pump starts at the Reflex Expression for 15 seconds then automatically switches to the Swift Expression and goes straight to the vacuum level that you last used.
3. Press the Expression Button when your milk starts to let down, to switch to the Natural Expression pattern. Adjust the Vacuum Adjusting Wheel to your desired suction level.
4. Press and hold the M Button M for three seconds, until the M icon flashes . That's it, your unique My Favorite Pattern is now set.
5. Continue to express your milk and finish your pumping session.

To recall the My Favorite Pattern:

1. Turn the Pump on.
2. Press the M Button M . (Do NOT hold more than 3 seconds)
3. Your pump automatically switches from Swift Expression to Natural Expression at the recorded let down time.

NOTE: *You CANNOT adjust the suction level or switch between Swift Expression and Natural Expression while in My Favorite Pattern. If you have to adjust the suction level, press the M Button once to exit My Favorite Pattern first.*

Setting the Time

How to Adjust the Clock:

1. While in the Clock/Standby Mode, press and hold the M Button Ⓜ for 3 seconds to go into Clock Setting mode. A beep will sound and the AM/PM icon will flash.
2. To change between AM/PM, use the Vacuum Adjustment Wheel up (+) or down (-).
3. Press the Expression Button once to change from AM/PM to the Hour. The Hour number will flash.
4. To change the Hour, use the Vacuum Adjusting Wheel to increase (+) or decrease (-) the hour.
5. Press the Expression Button again to change the minutes. The Minute number will flash.
6. To change the Minutes, use the Vacuum Adjusting Wheel to increase (+) or decrease (-) the minutes.
7. Press the Expression Button one last time to save your settings .

NOTE: *While in any Clock Setting mode, if no adjustments are made within 10 seconds, the setting will automatically save and the LCD Screen will return to Clock/Standby Mode.*

Setting the Time (Continued)

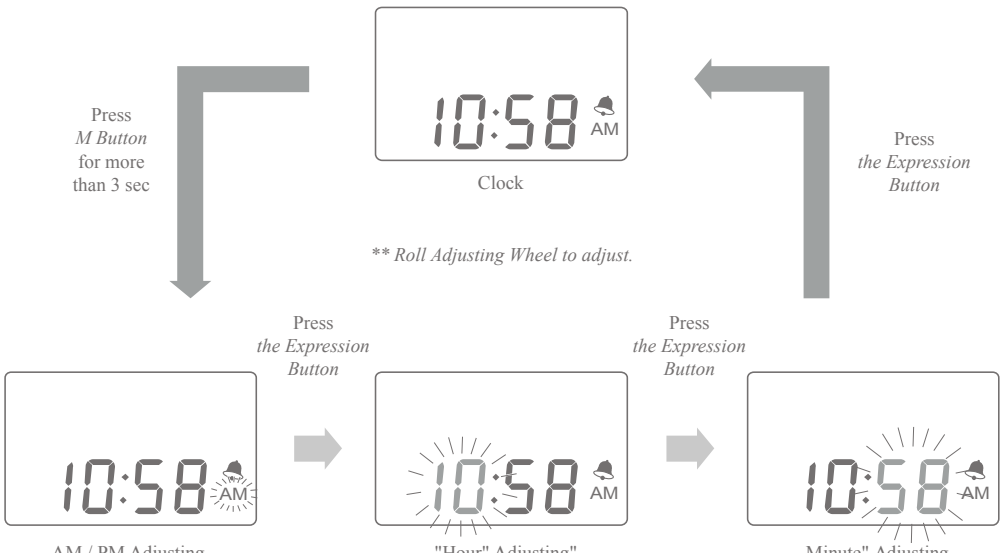

Alarm Clock Mode

It is advised to pump regularly in order to maintain a good milk supply from your body. The Alarm Clock Mode is designed to remind you when it's time for your next pumping cycle. By keeping a regular expression pattern, your body maintains a good milk supply. After setting the time interval between each pumping session, the Alarm countdown will automatically start after the previous pumping cycle has stopped. An alarm will sound when the pre-set time has passed.

How to Adjust the Alarm:

1. 1. In Clock/Standby Mode, press the M Button once to go into the Alarm Adjusting Mode.
2. Two sets of time will display alternately; the Alarm Interval Time (which is the time between each pumping session) and the Next Alarm Time.
3. Roll the Vacuum Adjustment Wheel up(+) or down (-) to adjust the Alarm Interval Time. The adjustment increases (+) or decreases (-) in 15 minute increments. The Next Alarm Time will be adjusted automatically according to the last time the pump was used.

NOTE: *The Alarm Interval Time is the time from the beginning of one Expression Pattern to the beginning of the next Expression Pattern. It is NOT the time from the ending of one Expression Pattern to the beginning of the next one.*

4. Press the Expression Button to switch to the Alarm On/Off setting.
5. Roll the Vacuum Adjustment Wheel up(+) or down(-) to turn the Alarm Function On/Off.
6. Press the Expression Button again to save your setting.
7. Press the Expression Button one last time to save your settings.

NOTE: *While in the Alarm Adjusting Mode, if no adjustments are made within 10 seconds, the setting will automatically save and the LCD Screen will return to Clock/Standby Mode.*

Alarm Clock Mode (Continued)

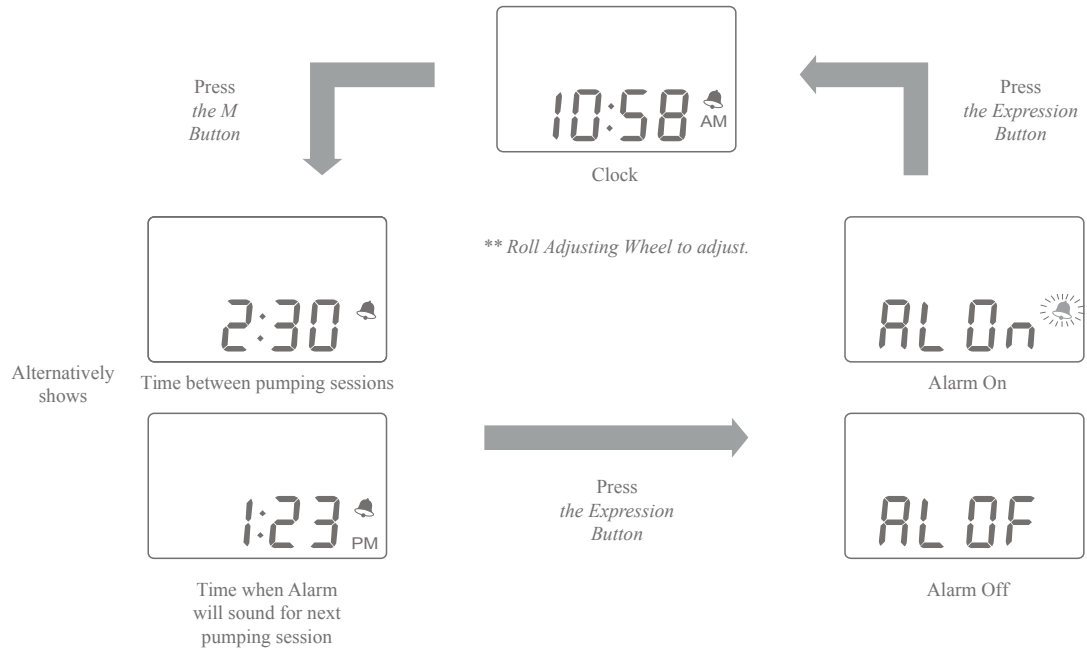

Cleaning Instructions

Unless otherwise instructed by your healthcare provider, follow these sanitizing and cleaning instructions.

Sanitize Prior to First Use:

Before you use your Drive Medical Duo Electric Breast Pump for the first time, disassemble and boil all parts of the Expression Collection Combo Kit and the Manual Diaphragm Add-on Kit in water for 10 minutes.

- Be sure to use enough water to keep all parts afloat while boiling.
- **Do NOT boil Tubing or Tubing Adapter.**
- Remove all parts from the water immediately after sterilizing. To avoid scalds and burns, do NOT touch the product with bare hands right after sterilizing.
- Completely air-dry or towel-dry before reassembling for next use.

Partially dry components may affect the operation of your Electric Breast Pump. Please ensure that all parts are completely dry before use.

Before Each Use:

- Wash your hands thoroughly with soap and warm water before handling the Expression Collection Combo Kit, the Electric Breast Pump, the Manual Pump Add-On or any Expression Collection parts or attachments.
- Make sure all parts are clean and dry.
- Ensure the Tubing is free from any liquid. **Do NOT operate your Drive Medical Duo Electric Breast Pump if any liquid is visible in the Tubing. (See Tubing Cleaning Instructions on page 22.)**

General Cleaning Instructions:



Caution: Take care when cleaning the One-Way Valve. If it gets damaged, your breast pump will not function properly. To clean the One-Way Valve, rub it gently between your fingers in warm soapy water, then rinse thoroughly in clean warm water. Do not insert any objects into the One-Way Valve as this may damage the valve.

- Set aside the Tubing and Tubing Connector. Under the normal working conditions of the pump, the diaphragm prevents the back-flow of milk. Therefore, these items do not need to be washed. In case of finding any liquid or liquid vapor inside the Tubing, follow the Tubing Cleaning Instruction (on page 22) carefully before use.
- All parts of the Expression Collection Combo Kit or Manual Diaphragm Add-On Kit may be cleaned in the upper compartment of your dishwasher or hand washed with dish soap in hot water.

Cleaning Instructions (Continued)

- Do NOT use solvents or abrasives.
- Rinse with hot, clean water.
- To clean the Electric Pump Main Unit, wipe it with a wet wipe or damp cloth, using only water or water mixed with a mild soap.

Tubing Cleaning Instructions:

- Wipe the outside of the Tubing with a clean, damp cloth. Avoid getting water or other fluids inside the Tubing.
- If liquids are found inside Tubing, rinse the Tubing with clean hot water. Hang to AIR DRY COMPLETELY BEFORE USING. Do NOT insert any object into the Tubing.

Note: *Before each use-visually inspect the individual components for cracks, chips, tears, discoloration or deterioration; as they may affect the efficiency of the Drive Medical Duo Electric Breast Pump. In the event that damage to the device is observed, please discontinue use until the parts have been replaced.*

Breastmilk Storage Guidelines

Check with your healthcare provider or an International Board Certified Lactation Consultant for specific storage instructions. This information is based on current research and applies to mothers who have healthy, full-term babies who are storing their milk for home use.

Important Notes:

- STORAGE CONTAINERS: The best option for storing human milk is glass or hard-sided plastic containers with well-fitting tops. When you are freezing your breastmilk, do not fill the container more than 3/4 full to allow for expansion from freezing. Store milk in the main refrigerator or freezer compartment, away from the door, to avoid changes in temperature that may compromise the milk.
- RE-WARMING THE FROZEN MILK: Frozen milk can be thawed in the refrigerator overnight or under cool running water. Gradually increase the temperature of the water to heat the milk to feeding temperature. Be sure to use thawed milk within 24 hours. Discard any leftovers.
- RE-WARMING THE REFRIGERATED MILK: Refrigerated milk can be warmed by running under warm water for several minutes. ALWAYS test the temperature of the milk on the inside of your wrist before feeding it to your baby. The milk should feel warm, not hot.
- WHAT TO DO: Storing milk in 2 to 4 oz amounts may reduce waste. Write the date you expressed your milk on the container (include your baby's name on the label if your baby is in a daycare setting). Use the oldest milk first. Throw away previously frozen milk that is not used within 24 hours.
- WHAT NOT TO DO: Do NOT heat milk directly on the stove. Do NOT thaw in hot or boiling water. Do NOT microwave milk, as microwaving alters the composition of the milk and may create hot spots that may burn your baby. Do NOT refreeze thawed milk.
- THAT'S WEIRD: Human milk may separate into a milk layer and a cream layer when it is stored. This is normal. Gently swirl to redistribute the cream before giving to baby. Sometimes thawed milk may smell or taste soapy. This is due to a breakdown in the milk fats. The milk is safe and most babies will still drink it.
- IS IT DANGEROUS: Expressed milk can be kept in a common refrigerator at the workplace or day care center. The US Center for Disease Control (CDC) and the US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) agree that human milk is not among the body fluids that require special handling or storage in a separate container.

Breastmilk Storage Guidelines (Continued)

Place	Temperature	How long	Things to know
Refrigerator	39°F or colder	● Up to 72 hours is best. ● Up to 5-8 days is okay for very clean expressed milk.	Store milk in the back of the main body of the refrigerator.
Freezer	0°F or colder	● Up to 6 months is best. ● Up to 12 months is okay.	Store milk toward the back of the freezer where temperature is most constant. Milk stored at 0°F or colder is safe for longer durations, but the quality of the milk might not be as high.
Smaller cooler with a blue-ice pack.	59°F	24 hours	Keep ice packs in contact with milk containers at all times; limit opening cooler.
Countertop, table	Room temp (60°F - 85°F)	● Up to 3-4 hours is best. ● Up to 6-8 hours is okay for very clean expressed milk.	Containers should be covered and kept as cool as possible; covering the container with a clean cool towel may keep milk cooler. Throw out any leftover milk within 1 to 2 hours after the baby is finished feeding.

Do not refreeze thawed milk. Discard any remaining thawed milk if not used within 24 hours.

Source: Breastfeeding Made Easier at Home and Work

Tips

Pumping Tips:
The most important and successful part of pumping is the let-down reflex. The let-down reflex is when your milk begins to flow freely.

- Try relaxing with a warm, wet compress on your breasts.
- Drink plenty of fluids.
- Avoid outside distractions.
- Visualize yourself happy, well rested and successful at pumping.
- Sometimes a light circular massaging of the breasts prior to and/or during a pumping session will help your let-down reflex start/continue.
- Go to a Non-stressful environment.
- Use a comfortable chair that gives lower back support with or without a footstool. After all, you're the one who has to be comfortable.

Depending on your health and milk production condition, you may be able to achieve more than one let down in one pumping session. Most mothers have more than one let-down while breast feeding and don't even notice the change. To achieve multiple let-downs which mimics the natural reflex found in breast feeding, you can switch the suction speeds T1 (fastest) and T4 (slowest) just by pressing the Expression Button.

Remember that successful pumping is a learned skill. Don't get discouraged, and keep working at it to obtain the best results. Breastmilk is produced on a supply and demand basis; expressing your breastmilk regularly stimulates and maintains your milk supply.

If it feels uncomfortable or painful on your breasts while using the Pump, try decreasing the suction level by rolling the Vacuum Adjusting Wheel down (-). You may also try pumping with/without the Silicone Cushion. If these tips do not help, turn the product off and remove the pump from your breasts for a few minutes. If you are still experiencing pain or discomfort, consult your healthcare professional or an international board certified lactation consultant.

Tips (Continued)

Battery Storage:

- When storing the battery for a short period of time, store within the following temperature range: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C).
- When storing the battery for an extended period of time, store within the following temperature range: 32°F to 77°F (0°C to 25°C).

Breastfeeding Tips:

- The Drive Medical Duo Electric Breast Pump helps you maintain a supply of milk and can help you prepare for planned events such as "Date Night" or unexpected events such as power outages, medical treatment, or relief from tender nipples.

Troubleshooting

Interruption of Electrical Service	If you experience an interruption of electrical service, due to a power surge or other factors, during normal operation of your Drive Medical Duo Electric Breast Pump, try the following: ● Unplug the AC/DC Adapter cord from the electrical outlet and wait for five seconds. ● Plug the AC/DC Adapter cord back into the electrical outlet. ● If problem persists, try a different electrical outlet.
Radio Frequency Energy	This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed properly and used in accordance with the instructions; it may cause harmful interference with other devices in the vicinity. Try the following: ● Reorient or relocate the device receiving interference. ● Increase the distance between the equipment. ● Connect the equipment into an outlet on a different circuit from that which the other device(s) are connected. ● Consult the manufacturer or a field service technician of the device receiving interference for help. ● There is no guarantee that interference will not occur.
Decreased Suction	If it feels like the suction has decreased, try the following: ● Make sure the Breast Pump is assembled correctly (see Assembly Instructions pages 8-13). ○ Inspect the One-Way Valve for any tears or pinholes. This component is critical to achieving proper suction. If damaged, replace the One-Way Valve with one of the spare valves that is provided with your Drive Medical Duo Electric Breast Pump. ● Detach the Tubing and Tubing Adapter from the back of your Electric Breast Pump and place a finger over the Tubing Adapter Inlet. ○ If you do feel suction, the Electric Pump Base is operating properly. ○ If you do NOT feel suction or feel that the suction has decreased to an unexpected strength; contact Drive Medical Customer Service for warranty service (see Page 31).

Troubleshooting (Continued)

No response while operate Adjusting Wheel and Mode button	You CANNOT adjust the suction level or switch between Swift Expression and Natural Expression while in My Favorite Pattern. If you have to, stop My Favorite Pattern by pressing the M Button.
Breastmilk Buildup in the Breastshield Body	If breastmilk doesn't appear to be draining fast enough into the Collection Bottle, reduce the suction setting on your Electric Breast Pump to allow the milk to drain before gradually increasing.
Where to get Replacement Parts	If you are missing a part or a part was damaged, please contact Drive Medical customer service by calling toll-free (866) 694-5085. You can purchase additional accessories for your Drive Medical Duo Electric Breast Pump by the following methods: ● Email: customerservice@drivemedical.com ● Fax: (516) 998-4601 ● Toll-Free: (866) 694-5085

Technical Data

Power Requirements:

- AC/DC Adapter (included) North American Plug configuration:
  Brand: Acute Ideas
  Model:GDP12AV-1201000, 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz, 0.45A, wall plug type AC/DC Adapter with DC 12V/1A output.
- Batteries:
  4 AA batteries; 1.5V Alkaline

Technical Specifications:

VACUUM:
Reflex / Swift Expression:-85~-185mmHg(-11.3~-24.6kpa)
Natural Expression:-110~-250mmHg(-14.6~-33.3kpa)
Ambient temperature range:+10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Relative Humidity range: 20% to 80%

Key to Box Symbol:

- Type BF equipment (Breastshield)
- Consult instructions for use
- Disposal of Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Made in China
Manufactured by Rumble Tuff®.

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide

Parts Guide:

● Manual Diaphragm Add-On

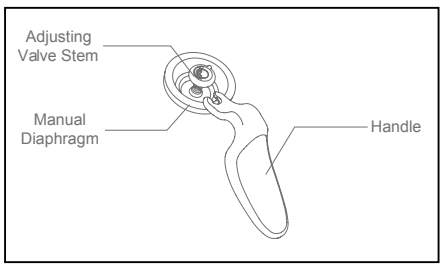

Note:

1. The parts in " ∗ " marks are specific to the Manual Breast Pump.

2. Parts specific to the Manual Breast Pump are included in a separate bag:

∗ Adjusting Valve Stem (Adjusting Valve + Valve Stem)

∗∗ Handle

∗∗∗ Manual Diaphragm

● Expression Collection Combo Kit

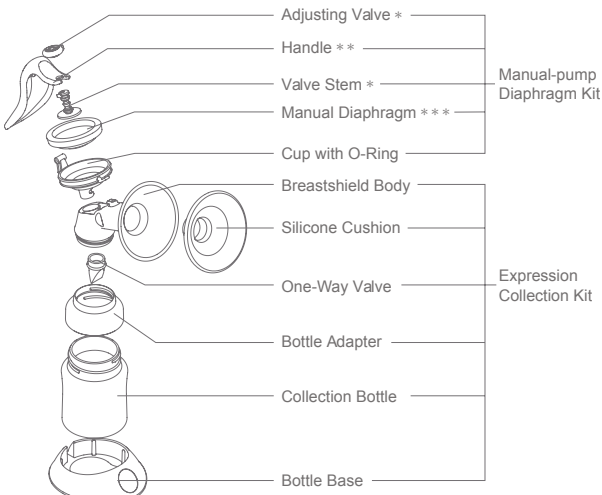

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide (Continued)

How to Assemble the Expression Collection Combo Kit:
Your Drive Medical Manual Breast Pump comes pre-assembled; however, you will need to re-assemble it after each cleaning. (For cleaning instructions, see Instruction and Assembly manual.) Below is a step-by-step guide for assembling the Expression Collection Combo Kit:

	1. Hold the "horn" of the Breastshield Body in one hand. Make sure the bottle-thread side opening is facing up.
	2. With the thumb and forefinger of the other hand, hold the tip of the One-Way Valve and place the flat circular bottom into the opening. Be sure not to stretch, bend, or twist the tip of the One-Way Valve. Seal all the edges of the flat circular bottom firmly. ***Note:*** *The One-Way Valve tip does not have to align with anything, as long as all the edges are securely sealed.*

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide (Continued)

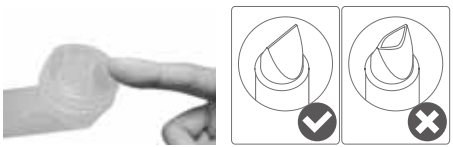

3. With your thumb and forefinger, gently smooth closed any openings on the tip of the One-Way Valve and shape into a straight line.
   Note: *This is critical to the optimal performance of the Pump.*

4. Carefully twist on the Bottle Adapter to the Breastshield Body for a secure fit.
   Note: *Be sure not to bump the One-Way Valve when twisting the Breastshield Body & the Adapter pieces together. If you bump the One-Way Valve, repeat step 3.*

5. With the Bottle Adapter in one hand, twist on the Collection Bottle for a secure fit.

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide (Continued)

How to Assemble the Manual-Pump Diaphragm Kit:

1. With the Cup in one hand, place the Manual Silicone Diaphragm in the Cup (matching the shape of the Cup). Press around the edges of the Diaphragm for a secure fit. Make sure the Diaphragm is evenly mounted on the Cup and there is no gap in between them.

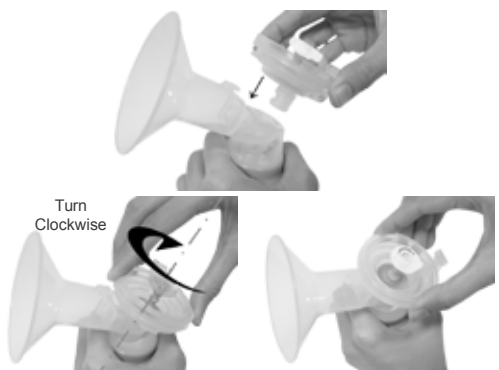

2. Twist the Manual-pump Diaphragm Kit clockwise into the Breastshield Body until it locks into place.

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide (Continued)

3. Place the "U" shape slot of the Handle onto the recess of the Adjusting Valve Stem. (There are 2 recesses on the Adjusting Valve Stem. The upper recess replicates the Swift Expression setting, and the bottom recess replicates the Natural Expression setting of Drive Medical Electric Pump.)



4. Push the Handle down onto the hinge of the Cup until it "snaps" into place.

5. With the Breastshield Body in one hand, place the Silicone Cushion in the Breastshield Body (matching the shape of the horn). Secure the lip of the Cushion around the edges of the horn. Your Manual Breast Pump will work with or without the Silicone Cushion. Your comfort depends on your preference.

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide (Continued)

Using the Manual Pump:

Note: *There are two recesses for attaching the handle to the Manual Pump. You can toggle between these two settings by pushing the Adjusting Valve Stem away from the "U" shape tip of the Handle to dislocate the connection. Reattach the tip of the Handle using a different recess on the Adjusting Valve Stem.*

Swift Expression Setting:
This setting is for a fast, shallow suction. Often, when a baby is hungry or has just "Latched-On," their nursing pattern is fast and shallow to start the mother's milk flow.

Natural Expression Setting:
This setting is for longer, deeper suction. When the mother's milk begins to flow into the baby's mouth (let-down), they often naturally change to a longer, deeper suction pattern.

1. Hold the Manual Breast Pump to your breast so that your nipple is centered inside the Breastshield. Then squeeze the handle toward the bottle to test the suction.
   Note: *If an adjustment is necessary, turn the round knob of the Adjusting Valve until the suction is comfortable.*

Increase Decrease

2. You can adjust the suction level by turning the round knob on the top of the Adjusting Valve Stem. Turn clockwise to increase the suction and counter-clockwise to decrease it.
   Note: *Do not over-turn the Adjusting Valve, as it will cause the Adjusting Valve to bulge and leak air, creating a suction problem. Make sure the gap opening on top of the Adjusting Valve is lined up properly on the top of the Valve Stem so the Adjusting Valve turns smoothly. If necessary, re-adjust the Adjusting Valve by turning back and forth a few times.*

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide (Continued)

Troubleshooting:

- **Insufficient Vacuum**

	• Center your nipple in the Breastshield. Ensure a complete seal of the Breastshield, making sure there are no gaps between the breast and the Breastshield.
	• Verify that the Handle is "snapped" into place against the Valve Stem. • Check the suction level by turning the the Adjusting Valve.
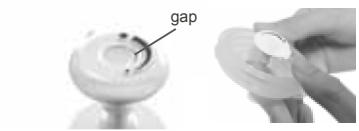	• Make sure the gap opening on top of Adjusting Valve is lined up properly on the top of the Valve Stem so the Adjusting Valve turns smoothly. If necessary, re-adjust the Adjusting Valve by turning back-and-forth a few times. • Make sure the Manual Diaphragm is sealed properly and that there is no gap between the Diaphragm and the Cup.
	• Check the O-Ring to make sure it is seated in the groove. • Make sure the Manual Pump Diaphragm Kit is locked into place on the Expression Collection Kit.
	• Verify that the One-Way Valve tip is securely seated and properly sealed. 

Warranty

Limited Consumer Product Warranty (United States)
This Drive Medical Electric Breast Pump is warranted to the original consumer "the purchaser" to be free from defects in material and workmanship which are not commercially acceptable for the period of one year from the date of purchase on the pump mechanism and a period of 120 days on all other components. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer this product to another person. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary by location.

DRIVE MEDICAL MAKES NO EXPRESS WARRANTY OF ANY KIND REGARDING THIS PRODUCT OTHER THAN THOSE WARRANTIES SET FORTH HEREIN. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF 120 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE BY THE ORIGINAL PURCHASER.

In the event that this product if found by Drive Medical to not meet the above limited warranty, as purchaser's sole and exclusive remedy, Drive Medical will repair or at the option of Drive Medical, replace this product without charge for such replacement parts or labor. The purchaser shall bear all expenses related to returning this product to Drive Medical. This warranty does not apply to any part of the product that has been subject to misuse, abuse, or alteration. Only Drive Medical brand replacement parts are recommended for use with Drive Medical breastfeeding products. Improper or incorrectly performed maintenance or repair, or use of non-Drive Medical brand replacement parts voids this warranty.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DRIVE MEDICAL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, REPLACEMENT COSTS RESULTING FROM THE BREACH OF ANY WRITTEN OR IMPLIED WARRANTY.

Warranty (Continued)

If you wish to make a claim under this warranty, you will need the following:

- The entire original Drive Medical product
- The original receipt showing date of purchase
- Return Authorization Number (RA#)
- Detailed description of the problem

You, the purchaser, are responsible for all shipping charges. Do NOT send product without a RA#.
To obtain a RA# and shipping address: Please contact Drive Medical Customer Service Department by;
Toll-free (866) 694-5085, or
E-mail to customerservice@drivemedical.com, or

In writing to:
Customer Service Department
Drive Medical
99 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11050

Items returned without a RA# will not be processed and will be returned to sender (postage due).

ES Felicitaciones

Felicitaciones por su nuevo Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical La Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical es perfecta para muchas ocasiones.

- Recolección de la leche materna, mientras que usted está lejos de su bebé
  - Por ejemplo: cuando estás en el trabajo
- Aliviar la congestión mamaria
  - Por ejemplo: cuando los hábitos de alimentación de su bebé cambian porque están comiendo más sólidos
- Mantenimiento de la producción de leche si tiene que temporalmente detener el amamantamiento
  - Por ejemplo: para extraer la leche inadecuada, mientras que se somete a un tratamiento médico

La Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical proporciona muchas de las características que las madres ocupadas aman.

- 3 ciclos de expresiones que imitan los patrones de lactancia del bebé.
  - Expresión Reflex - Lach y enraizamiento en hábito
  - Expresión Rapida - Rápido pero poco profundo hábito de deglución
  - Expresión Natural - Estable y fuerte patrón de deglución
- Protección contra el reflujo de la leche
- Motor silencioso para discreción
- Pequeño y ligero
- 2 opciones de energía para satisfacer sus necesidades
  - Adaptador AC / DC
  - 4 pilas alcalinas tipo AA (no incluidas)
- Convierte a la bomba manual en cuestión de segundos (piezas incluidas).

Indicación para el uso

La Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical es para uso personal, un dispositivo eléctrico utilizado para extraer la leche de los pechos de las mujeres en período de lactancia. Este dispositivo no está diseñado para uso hospitalario.

Tabla de contenido

Felicitaciones 0
Indicación para el uso 0
Medidas de seguridad importantes 3
- PELIGRO 3
- PRECAUCIÓN 3
- ADVERTENCIA 3

Guía de Piezas 5
- Unidad principal de la bomba eléctrica 6
- Guía de la pantalla del LCD 6
- Juego de Combinación para Colección de leche extraída 7

Cómo armar el juego de Colección para leche extraída 8
Cómo armar el Juego de Diafragma de la bomba eléctrica 11
Cómo armar el Juego de Colección de leche extraída 12
Opciones de energía 14
- Uso del adaptador AC / DC (incluido) 14
- El uso de 4 Pilas alcalinas tipo AA (baterías no incluidas) 15
- Instale las pilas (alcalinas AA) 16

Instrucciones para el bombeo 18
Nivel de succión 23
M pulsador 24
Ajustar la hora 25
- Cómo ajustar el reloj 25

Modo de despertador 27
- Cómo ajustar la alarma 27

Instrucciones de limpieza 29
- Esterilice Antes de Primer Uso 29
- Antes de cada uso 29
- Instrucciones generales de limpieza 29

- Instrucciones de limpieza de tubos 30

Guia para el almacenamiento de la leche materna 31
- Notas Importantes 31

Sugerencias 33
- Sugerencias para el bombeo 33
- Almacenamiento de la batería 34
- Consejos sobre el amamantamiento 34

Solución de problemas 35
- Interrupción del servicio eléctrico 35
- Energía de radiofrecuencia 35
- Disminución de Succión 35
- La leche materna se acumulan en el cuerpo de la copa de pecho 36
- Dónde obtener piezas de repuesto 36

Datos técnicos 37
- Requerimientos de Energía 37

Manual Breast Pump - Quick Reference Guide 38
- Guía Partes 38
- Cómo armar la Expresión Kit Colección Combo 39
- Cómo Armar el Manual de la Bomba de Diafragma Kit 41
- Uso de la Bomba Manual 43
- Solución de Problemas 44

Garantía 45

Medidas de Seguridad Importantes

La Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical está diseñada para un solo usuario y nunca debe ser compartida o revendida; Al hacerlo se anulará la garantía.

LEA TODA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USO

PELIGRO: Para reducir el riesgo de electrocución:
- Siempre desconecte este producto inmediatamente después de su uso.
- No la use mientras se baña.
- No coloque ni guarde este producto donde se pueda caer o ser tirado en una bañera o en un lavamanos.
- No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- No intente alcanzar un producto eléctrico que haya caído al agua. Desconectelo inmediatamente.

PRECAUCIÓN:
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea indicado en las Instrucciones y Asamblea.
- Asegúrese de que todas las partes sean ensambladas correctamente antes de operar.
- Deje de utilizar la bomba de pecho inmediatamente si sus senos o pezones sienten algúna molestia.
- Por favor, lávese las manos antes de usar este producto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los bebés y los niños.
- No deje caer o golpee el producto para evitar daños a los componentes internos.
- No toque el producto con las manos inmediatamente después de la esterilización por agua hirviendo para evitar escaldaduras y quemaduras.
- No se exceda en hervir para evitar el envejecimiento prematuro de los materiales del producto.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:
- Este producto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
- Atenta supervisión es necesaria cuando este producto se utiliza cerca de niños o inválidos.
- Utilice este producto sólo para el uso intencionado como se describe en este manual. No use accesorios o piezas no recomendadas por Drive Medical.
- No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído en el agua.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No lo utilice mientras duerme o está adormecida.
- No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o tubo.
- No lo utilice al aire libre con el adaptador AC / DC, ni donde se están usando productos de aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
junto con su recibo para referencia futura.

Medidas de seguridad importantes (Continúa)

- Asegúrese de que el voltaje del adaptador AC / DC es compatible con la fuente de poder.
- Conecte el adaptador de AC / DC en el enchufe eléctrico antes de enchufar el cable de energía en su Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical.
- Drive Medical ha proporcionado un adaptador AC / DC con este dispositivo. El uso de ningún otro adaptador AC / DC no aprobado por el fabricante anula la garantía.
- Si usted está infectada con Hepatitis A, Hepatitis B, o tiene VIH/SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Humana): el bombeo de la leche materna no reduce ni elimina el riesgo de transmitir el virus a su bebé a través de la leche materna.
- Lave los componentes del Juego de Combinación para Colección de leche extraída antes de cada uso.
- No opere un vehículo de motor mientras utiliza La Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical.
- No intente modificar el producto.

Guía de Partes



Unidad Principal del Extractor de Leche



Adaptador AC / DC



Tubos de succión con adaptador



Juego de Combinación para Colección de leche extraída (2 juegos)



Juego de adaptador de botella (2 juegos)

Diafragma Manual Kit de Add-On

Guía de Partes

● Unidad principal de la bomba eléctrica

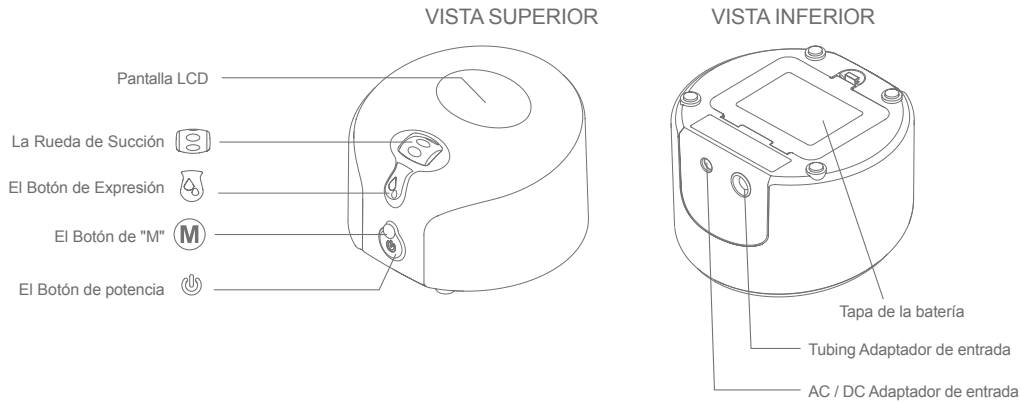

● Guía Pantalla LCD

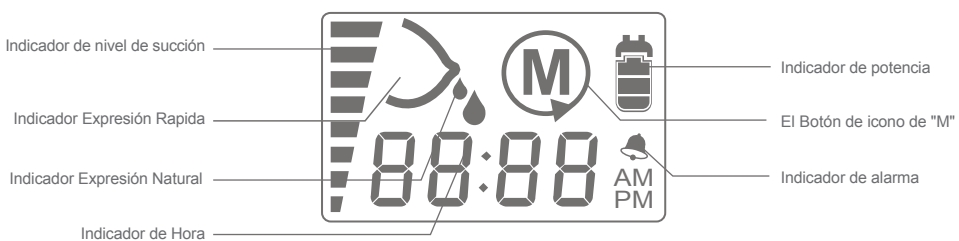

Guía de partes

● **Expresión Kit Colección Combo (Duo)**

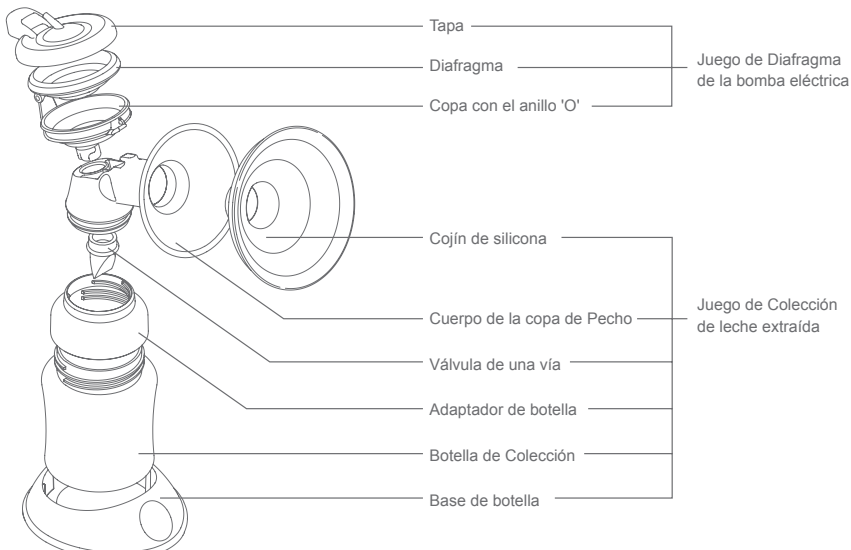

Cómo armar el Juego para la Colección de Leche extraída

Su Doble Bomba de Pecho Eléctronica Drive Medical viene preensamblada; Sin embargo, tendrá que volver a montar después de cada limpieza. (Para obtener instrucciones de limpieza, consulte la página 21) A continuación se muestra una guía paso a paso para el montaje del Juego de Colección de Leche extraída:

1. Sostenga el "cuerno" del cuerpo de la copa de Pecho con una mano. Asegúrese que la abertura lateral de la rosca de la botella quede hacia arriba.

2. Con el pulgar y el dedo índice de la otra mano, sostenga la punta de la válvula de una vía y coloque la parte inferior plano y circular en la abertura. Asegúrese de no estirar, doblar o retorcer la punta de la válvula de una vía. Sella firmemente todos los bordes de la parte inferior circular plano.

Nota: *La punta de la válvula de una vía no tiene que alinear con cualquier cosa, siempre y cuando todos los bordes estén bien sellados.*



Cómo armar el Juego de Colección de Leche extraída(Continuación)

3. Con el dedo pulgar e índice suavemente cierre cualquier abertura en la punta de la válvula de una via y formala en una línea recta.

Nota: *Esto es fundamental para el funcionamiento de la bomba.*



4. Gire con cuidado el adaptador de la botella al Cuerpo de la copa de Pechos para un ajuste seguro.

Nota: *Asegúrese de no golpear la válvula de una vía cuando se tuerce el Cuerpo de la Copa de Pechos y las piezas del adaptador de la botella juntos. Si golpee la válvula de una vía, repita el paso 3.*

Cómo armar el Juego de Colección de Leche extraída(Continuación)

5. Con el adaptador de la botella en una mano, gire a la botella de Colección para un ajuste seguro.

Cómo armar el Juego de Diafragma de la bomba eléctrica

1. Con la Copa en una mano, coloque el diafragma de silicona en la Copa (coincide con la forma de la Copa). Presione alrededor de los bordes del Diafragma para un ajuste seguro. Asegúrese de que el diafragma este montado de manera uniforme sobre la Copa y no quede espacio entre ellos.

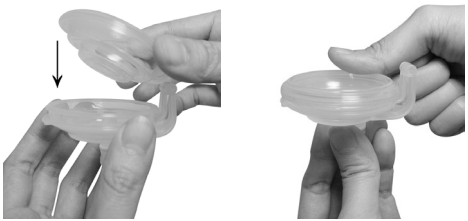

2. Coloque la tapa en la Copa y del diafragma. (Asegúrese de alinear la bisagra y la cubierta de la bisagra) Presione firmemente para sellar.

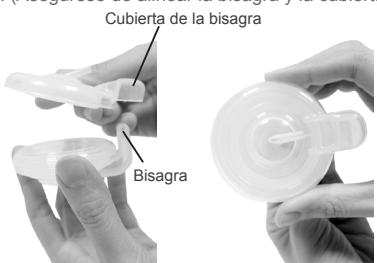

Cómo armar el Juego de Combinación de Colección de Leche expresada

1. Con la cara del anillo O hacia abajo, ponga el Juego del diafragma de la bomba eléctrica en la parte superior del Cuerpo de la Copa de Pechos. Gire el Juego de diafragma de la bomba eléctrica a la derecha en el Cuerpo de la Copa de Pechos hasta que encaje en su lugar.

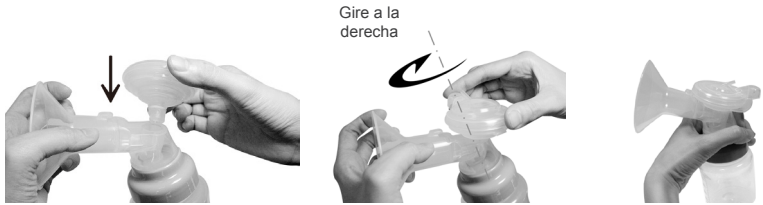

2. Con el Cuerpo de la Copa de Pechos en una mano, coloque la almohadilla de silicona en el Cuerpo de la Copa de Pechos (coincide con la forma de la bocina).Asegure que el borde del Cojín esten alrededor de los bordes de la bocina

Nota: *El extractor de leche eléctrico funcionará con o sin la Almohada de silicona. Su comodidad depende de su preferencia.*

Cómo armar el Juego de Combinación de Colección de Leche expresada (Continuación)

3. Conecte el tubo con el adaptador más pequeño situado ensima de la Botella. Empuje juntos firmemente para un sello hermético.

Nota: *Asegúrese de que no haya humedad en el tubo.*

****Para uso como Bomba única:***
Retire un tubo y cierre el conector en T.

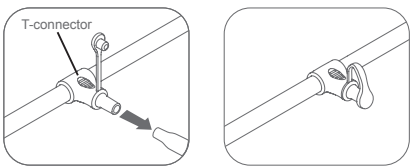

4. Asegúrese de que el conector del tubo esté correctamente insertado en el adaptador del Tubo de entrada de la unidad principal de la bomba eléctrica.

Opciones de Energía

Su Extractor de Leche Eléctrico puede operar bajo cualquiera de los siguientes modos de suministro de energía:

Usando el adaptador AC / DC (incluido):

- Seguridad eléctrica sólo se puede lograr cuando se utiliza el adaptador de AC / DC que se proporciona con la bomba. El uso de cualquier otro adaptadores puede causar preocupación por la seguridad del producto y / o el usuario y anula la garantía.

1. Enchufe el adaptador de AC / DC en un enchufe eléctrico.

2. Conecte el cable de poder al adaptador de entrada de AC / DC de la unidad principal de la bomba eléctrica.

Opciones de Energía (Continuado)

Utilize 4 pilas AA alcalinas:

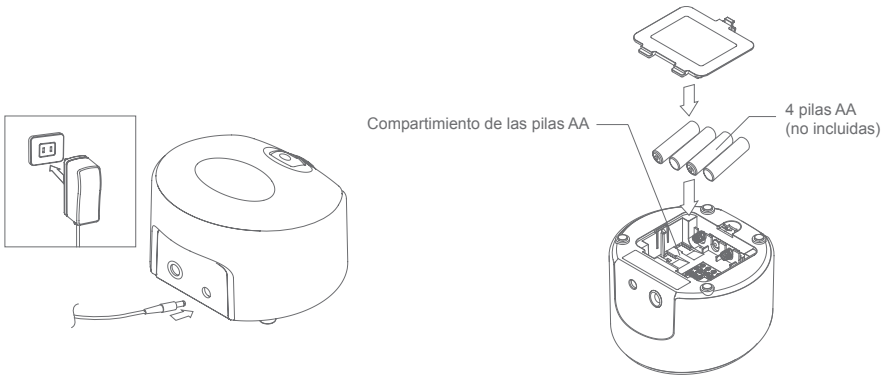

- Siempre cambie todas las 4 pilas AA al mismo tiempo.
- Retire todas las baterías de la Base de la bomba eléctrica si La Doble Bomba de Pecho Electronica Drive Medical no va a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
- Deseche correctamente todas las baterías, de acuerdo a las regulaciones para la protección del medio ambiente y el reciclaje.

Nota: *as pilas alcalinas pueden presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas. No desarme ninguna batería. NO coloque las pilas cerca de fuentes de calor o fuego. Deshágase de las pilas usadas. NO arroje las baterías al fuego. Mantener alejado de los niños.*

Instalar las Pilas: alcalinas AA

1. Abra la cubierta de la batería.

2. Retire las pilas usadas si las va a reemplazar.

Instalación de las Pilas: Alcalinas AA (Continuación)

3. Inserte 4 nuevas baterías alcalinas AA. No mezcle pilas nuevas y viejas.

Nota: *Asegúrese de que la polaridad sea correcta según lo indicado.*



4. Cierre la cubierta de la batería, asegurándose de que "encajen" en su lugar.

Instrucciones para bombeo

1. Mantenga el Juego de Colección de Leche a su pecho para que su pezón se centra dentro la Copa de Pechos.

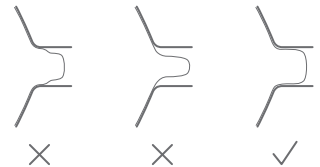

Nota: *Compruebe la correcta colocación del escudo.*

2. Presione el botón de encendido para iniciar el bombeo.

Instrucciones para Bombeo (Continúa)

3. La pantalla LCD muestra la hora de la última sesión de bombeo por unos cuantos segundos. La bomba iniciará automáticamente desde la Extracción de reflejo por 15 segundos y luego se cambiará automáticamente a la Extracción rápida.

4. Ajuste la succión en la Extracción rápida a su nivel más cómodo mientras bombea, girando la rueda de ajuste de vacío arriba (+) o abajo (-).

Instrucciones para Bombeo (Continúa)

5. Dependiendo de su preferencia y el hábito de succionar de su bebé, usted puede elegir extraer su leche en la configuración Extracción rápida o Extracción natural . Para cambiar de la Extracción rápida a la Extracción natural pulse el botón Extracción una vez.

Botón de extracción

6. Para revisar en cual configuración de extracción se encuentra, revise la pantalla LCD para ver el icono del ciclo de extracción. El icono en forma de seno indica si usted está en la configuración de Extracción de Reflejo o Rápida. El icono del seno con gotas de leche indica que usted se encuentra en la configuración de Extracción Natural.

Extracción Reflejo/ Rápida

Extracción Natural

Instrucciones para Bombeo (Continúa)

7. Ajuste la succión mientras bombea en la Extracción Natural al nivel más cómodo y eficaz al girar la Rueda de Ajuste de Vacío hacia arriba (+) o hacia abajo (-).

8. Al terminar su sesión de bombeo, apague la bomba presionando el Botón de potencia.

Instrucciones para Bombeo (Continúa)

9. Después de apagar la bomba, la pantalla LCD permanecerá encendida por unos cuantos segundos. La pantalla mostrará la cantidad total de tiempo de bombeo, luego se cambiará automáticamente al modo Standby/Clock (Espera/Reloj), o el modo Alarm Clock (Reloj de alarma) si la alarma está activada.

***Nota**: Asegúrese de que no exista succión en el pezón antes de retirar la copa del seno. De ser necesario, interrumpa la succión introduciendo un dedo entre la copa del seno y el seno, de manera similar a cuando interrumpe la succión de su bebé.*

***Nota:** Si la bomba eléctrica para seno Drive Medical Duo se deja encendida pero sin usar por más de 30 minutos, la bomba se apagará automáticamente.*

Nivel de succión

Cuando selecciona un nivel de succión (en cualquier configuración de extracción), su bomba eléctrica para seno Drive Medical Duo lo recuerda hasta que usted lo cambie. Esta opción es muy útil después de que se familiariza con esta bomba. Su bomba para seno conserva en la memoria su nivel de bombeo anterior sin tener que volver a reiniciar su nivel preferido cada vez que bombea.

Para establecer su nivel de succión preferido:
1. En la Extracción reflejo / rápida, ajuste el nivel de succión al nivel más cómodo para usted girando la rueda de ajuste de vacío hacia arriba (+) o hacia abajo (-).
2. En la Extracción natural, ajuste el nivel de succión de vacío al nivel con mayor eficacia pero que aún así siga estando cómodo al girar la rueda de ajuste de vacío hacia arriba (+) o hacia abajo (-).

Botón M (Mi Patrón Favorito)

Una de las grandes características de su bomba eléctrica para seno Drive Medical Duo es el Botón M (mi patrón favorito). Usted puede fácilmente fijar y recuperar su patrón personal de extracción al pulsar el Botón M. Es de suma utilidad si utiliza regularmente la configuración de Extracción natural para extraer su leche. Usted no necesita usar el Botón M si usted utiliza normalmente la Extracción rápida para su extracción.

Para programar "Mi Patrón Favorito":

1. Después de bombear varias veces, usted se va a dar cuenta que su tiempo en que le baja la leche es casi el mismo en cada sesión de bombeo.
2. Empiece a bombear como lo hacer normalmente. Su bomba empieza en la Extracción de Reflejo por 15 minutos y luego se cambia automáticamente a la Extracción Rápida y se va directo al nivel de vacío que usó por última vez.
3. Oprima el Botón Extracción cuando empiece a bajar la leche, para cambiar al patrón de Extracción Natural. Ajuste la Rueda de Ajuste de Vacío a su nivel de succión deseado.
4. Oprima y mantenga presionado el Botón M (M) por tres segundos, hasta que parpadee el icono M . Eso es todo, ya estableció Mi Patrón Favorito.
5. Continúe extrayendo su leche y termine su sesión de bombeo.

Para volver a recuperar "Mi Patrón Favorito":

1. Encienda la bomba. ⏻
2. Presione el Botón M (M). (NO lo mantenga presionado por más de 3 segundos.)
3. Su bomba se cambia automáticamente desde la Extracción Rápida a la Extracción Natural en el tiempo registrado en que le baja la leche.

NOTA: *Usted NO puede ajustar el nivel de succión o cambiar entre la Extracción Rápida y Extracción Natural mientras se encuentra en "Mi Patrón Favorito". Si tiene que ajustar el nivel de succión, oprima el Botón M una vez para salir primero de "Mi Patrón Favorito".*

Configuración del Tiempo

Cómo Ajustar el Reloj:

1. Mientras se está en el modo Reloj/Espera, oprima y mantenga presionado el Botón M (M) por 3 segundos para pasar al modo Configuración de Reloj. Escuchará un pitido y parpadeará el icono AM/PM.
2. Para cambiar entre AM/PM, utilice la Rueda de Ajuste de Vacío hacia arriba (+) o hacia abajo (-).
3. Oprima el Botón de Extracción una vez para cambiar desde AM/PM a la Hora. El número de Hora parpadeará.
4. Para cambiar la hora, utilice la Rueda de Ajuste de Vacío para aumentar (+) o disminuir (-) la hora.
5. Oprima de nuevo el botón de Extracción para cambiar a minutos. El número de Minuto parpadeará.
6. Para cambiar los minutos, utilice la Rueda de Ajuste de Vacío para aumentar (+) o disminuir (-) los minutos.
7. Oprima por última vez el Botón Extracción para guardar su configuración .

NOTA: *Mientras se encuentra en el modo Configurar reloj, si no se hace un ajuste dentro de 10 segundos, la configuración se guardará automáticamente y la pantalla LCD regresará al modo Reloj/Espera.*

Configuración del tiempo (continuación)

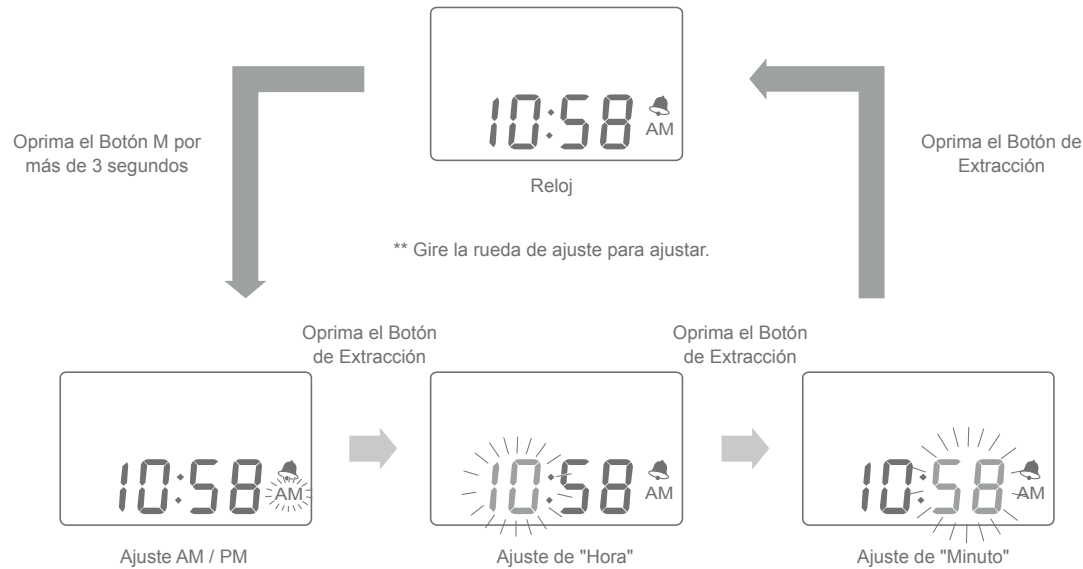

Modo de Alarma de Reloj

Se recomienda que bombee con regularidad para mantener un buen suministro de leche desde su cuerpo. El modo de alarma de reloj está diseñado para recordale cuándo es tiempo para su siguiente ciclo de bombeo. Al mantener un patrón de extracción regular, su cuerpo mantiene un buen suministro de leche. Después de programar el intervalo de tiempo entre la sesión de bombeo, iniciará automáticamente el conteo regresivo de la Alarma después de terminar el ciclo de bombeo anterior. Se escuchará una alarma al pasar el tiempo pre-establecido.

Cómo ajustar el alarma:

1. En el modo Reloj/Espera, oprima el botón M (M) una vez para pasar al Modo de Ajuste de Alarma.
2. Aparecerán dos tiempos en forma alternante; la hora de intervalo de alarma (que viene siendo el tiempo entre cada sesión de bombeo) y el tiempo de la siguiente alarma.
3. Gire la Rueda de Ajuste de Vacío hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para ajustar el intervalo de tiempo de la alarma. El ajuste aumenta (+) o disminuye (-) en incrementos de 15 minutos. El tiempo de la siguiente alarma se ajustará automáticamente de acuerdo con la última vez que se usó la bomba.

NOTA: *El tiempo de intervalo de alarma es la hora desde el inicio de un Patrón de extracción hasta el inicio del siguiente Patrón de extracción. NO es el tiempo desde el final de un Patrón de extracción hasta el inicio del siguiente.*

4. Oprima el Botón Extracción para cambiar la configuración de encendido/apagado de la alarma.
5. Gire la Rueda de Ajuste de Vacío hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para encender/apagar la función de alarma.
6. Oprima de nuevo el Botón de Extracción para guardar su configuración.
7. Oprima por última vez el Botón Extracción para guardar su configuración.

NOTA: *Mientras se encuentra en el Modo Ajustar alarma, si no se hace un ajuste dentro de 10 segundos, la configuración se guardará automáticamente y la pantalla LCD regresará al modo Reloj/Espera.*

Modo de Alarma de Reloj (continuación)

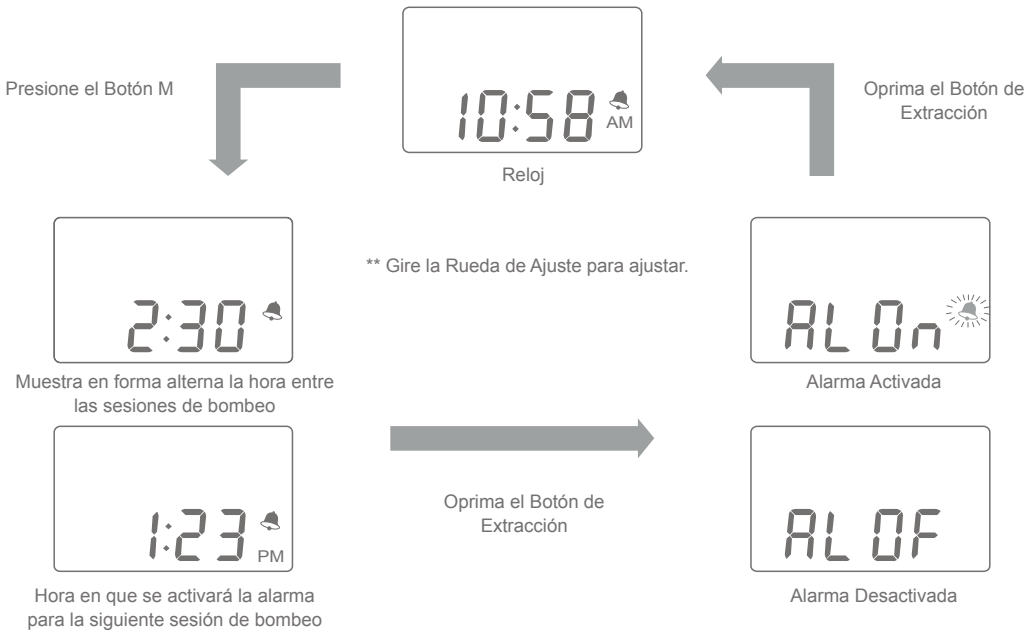
Presione el Botón M
10:58 AM
Reloj
Oprima el Botón de Extracción
2:30
Muestra en forma alterna la hora entre las sesiones de bombeo
** Gire la Rueda de Ajuste para ajustar.
AL On
Alarma Activada
1:23 PM
Hora en que se activará la alarma para la siguiente sesión de bombeo
Oprima el Botón de Extracción
AL OF
Alarma Desactivada

Instrucciones de Limpieza

A menos que se lo indique su proveedor de atención médica, siga estas instrucciones de desinfección y limpieza.

Desinfecte Antes de Primer Uso:

Antes de usar su Doble Bomba de Pechos Electrica Drive Medical por primera vez, desarmela y ponga a hervir todas las partes del Juego de Combinación de Colección de Leche Expresada y su agregación de Juego de Diafragma Manual en agua durante 10 minutos.

- Asegúrese de utilizar suficiente agua para mantener todas las partes a flote mientras esten hirviendo.
- **NO hierva los Tubos o los adaptadores de los Tubos.**
- Retire todas las piezas del agua inmediatamente después de la esterilización. Para evitar escaldaduras y quemaduras, no toque el producto con las manos justo después de la esterilización.
- Seca totalmente al aire o con una toalla antes de montar para el próximo uso.

Componentes parcialmente secos pueden afectar la operación de su Doble Bomba de Pechos Eléctrica. Asegúrese de que todas las partes estén completamente secas antes de su uso.

Antes de cada uso:

- Lávese bien las manos con agua tibia y jabón antes de tocar el Juego de Combinación de Colección de Leche Expresada, la Doble Bomba de Pechos Eléctrica, y la bomba manual o cualquier otras partes o accesorios.
- Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
- Asegúrese de que los Tubos esten libre de cualquier líquido. **No utilice su Doble Bomba de Pechos Drive Medical Eléctrica si hay líquido visible en el tubo. (Vea las instrucciones de limpieza de tubos en la página 22.)**

Instrucciones Generales de limpieza:

Precaución: Tenga cuidado al limpiar la válvula de una vía. Si se daña, la bomba de pecho no funcionará correctamente. Para limpiar la válvula de una vía, lavela suavemente entre sus dedos con agua tibia y jabón, luego enjuaguela bien con agua tibia y limpia. No inserte ningún objeto en los válvula de una vía, ya que puede dañar la válvula.

- Ponga a un lado los Tubos y los Connectores de los Tubos. En las condiciones normal de trabajo de la bomba, el diafragma evita el flujo de retorno de la leche. Por lo tanto, estos elementos no necesitan ser lavados. En el caso de cualquier líquido o vapor de líquido dentro de los tubos, siga las instrucciones de limpieza de tubos (en la página 22) antes de utilizarlo.
- Todas las partes del Juego de Combinación de Colección de Leche Expresado o Juego de adición del Diafragma Manual se pueden limpiar en el compartimiento superior de su lavaplatos o se puede lavar a mano con jabón en agua caliente.

Instrucciones de limpieza (Continúa)

- No utilice solventes o abrasivos.
- Enjuague con agua limpia y caliente.
- Para limpiar la unidad principal de la bomba eléctrica, pásele una toallita húmeda o un paño húmedo, utilizando solamente agua o agua mezclada con un jabón suave.

Instrucciones de limpieza de los Tubos:

- Limpie el exterior de la tubería con un paño limpio y húmedo. Evite que le entre agua o otros líquidos dentro de la tubería.
- Si encuentra líquidos en el interior de la tubería, enjuague el tubo con agua caliente y limpia. Luego Cuelgue el tubo a secar completamente al aire ANTES DE USAR. NO inserte ningún objeto en la tubería.

Nota: *Antes de cada uso, inspeccione visualmente los componentes individuales en busca de grietas, astillas, desgarros, decoloración o deterioro; ya que esto puede afectar la eficiencia de la Doble Bomba de Pecho Electrica de Drive Medical. En el caso de que se observaron daños en el dispositivo, por favor deje de usarlo hasta que las piezas han sido sustituidas.*

Guías para el almacenamiento de la leche materna

Consulte con su proveedor de atención médica o un Consultor de Lactancia Certificada para obtener instrucciones específicas de almacenamiento. Esta información está basada en investigaciones actuales y se aplican a las madres que tienen bebés sanos, a término y están almacenando su leche para uso doméstico.

Notas importantes:

- CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO: La mejor opción para el almacenamiento de la leche humana es en contenedores de vidrio o de plástico duro con tapas que ajusten bien. Cuando usted está congelando la leche materna, no llene el recipiente más de 3/4 de su capacidad para permitir la expansión de la congelación. Almacene la leche en el compartimento principal del refrigerador o congelador, lejos de la puerta, para evitar los cambios de temperatura que pueden comprometer la leche.
- RE-calentamiento de la leche congelada: La leche congelada puede descongelarse en el refrigerador durante la noche o bajo agua corriente fría. Gradualmente aumente la temperatura del agua a calentar la leche a la temperatura de alimentación. Asegúrese de utilizar la leche descongelada dentro de las 24 horas. Deseche las sobras.
- RE-CALENTAMIENTO DE LA LECHE REFRIGERADA: Leche refrigerada puede calentarse bajo un chorro de agua caliente durante varios minutos. SIEMPRE prueba la temperatura de la leche en la parte interior de su muñeca antes de alimentar a su bebé. La leche debe sentirse tibia, no caliente.
- QUÉ HACER: Almacenamiento de la leche en cantidades de 2 a 4 onzas puede reducir los residuos. Escriba la fecha en la que expresó su leche en el recipiente (incluya el nombre de su bebé en la etiqueta si su bebé está en una guardería). Use la leche más vieja primero. Tire a la basura la leche previamente congelada que no se utiliza dentro de las 24 horas.
- QUÉ NO HACER: No caliente la leche directamente en la estufa. NO descongele en agua caliente o hirviendo. NO debe calientar la leche en el microondas, los microondas alteran la composición de la leche y pueden crear puntos calientes que pueden quemar a su bebé. No vuelva a congelar la leche descongelada.
- Es Extraño: La leche humana puede separarse en una capa de leche y una capa de crema cuando se almacena. Esto es normal. Agite suavemente para redistribuir la crema antes de dársela a su bebé. A veces la leche descongelada puede oler o tener un gusto jabonosa. Esto es debido a una interrupción en las grasas de la leche. La leche es segura y la mayoría de los bebés todavía la tomaran.
- ES PELIGROSO?: La leche extraída puede ser guardada en un refrigerador común en el de trabajo o la guardería. El Centro de EE.UU. para el Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU. (OSHA) estan de acuerdo que la leche materna no está entre los fluidos del cuerpo que requieren un manejo especial o almacenamiento en un recipiente aparte.

Guías de almacenamiento de leche materna (Continúa)

Lugar	Temperatura	Cuanto Tiempo	Lo que debe saber
Refrigerador	39 ° F o más frío	● Hasta 72 horas es lo mejor. ● Hasta 5-8 días esta muy bien para la leche extraída y limpia.	Almacéne la leche en la parte posterior de la parte principal de el refrigerador.
Congelador	0 ° F o más frío	● Hasta 6 meses es lo mejor. ● Hasta 12 meses es aceptable.	Guarde la leche hacia el fondo del congelador, donde la temperatura es más constante. La leche almacenada a 0 ° F o más frío es seguro durante más tiempo, pero la calidad de la leche no es tan alta.
Pequeño conservador con un paquete de hielo azul.	59°F	24 horas	Mantenga una bolsas de hielo en contacto con el contenedor de leche en todo momento; limite la apertura del contenedor para mantener la leche más fresca.
Mostrador, Mesa	Temperatura de la habitación (60 ° F - 85 ° F)	● Dentro de 3 - 4 horas es lo mejor. ● Dentro de 6 - 8 horas es aceptable para que la leche todavia este limpia.	Los recipientes deben estar cubiertos y mantenidos lo más fresco posible; cubra el recipiente con una toalla limpia y fresca asi puede mantener la leche más fría. Deseche cualquiera leche sobrante dentro de 1 a 2 horas después de que el bebé finalizó la alimentación

No vuelva a congelar la leche descongelada. Deseche cualquier leche descongelada restante si no se utiliza dentro de 24 horas.

Fuente: La lactancia materna hecha más fácil en el hogar y el trabajo www.womenshealth.gov

Sugerencias

Recomendaciones de Bombeo:
La parte más importante y exitosa de el bombeo es el reflejo de bajada. El reflejo de bajada es cuando la leche comienza a fluir libremente.

- Trate de relajarse con un Paño húmedo y caliente sobre sus senos.
- Tome líquidos en abundancia.
- Evite las distracciones externas.
- Visualízate feliz, bien descansada y con éxito en el bombeo.
- A veces un masaje circular a los pechos antes y / o durante una sesión de extracción ayudará a su inicio de bajada de reflejo / continuar.
- Vaya a un ambiente no estresante.
- Utilice una silla cómoda que de soporte para su espalda con o sin un escabel. Después de todo, tú eres la que tiene que estar cómoda.

Dependiendo de su estado de salud y condición la producción de leche, puede ser capaz de lograr más de una decepción en una sesión de extracción. La mayoría de las madres tienen más de una decepción, durante la lactancia materna y no se dan cuenta del cambio. Para lograr múltiples bajadas que imitan el reflejo natural que se encuentra en periodo de lactancia, puede cambiar entre Expresión rapida y Expresión Natural con sólo pulsar el botón de expresión.

Recuerde que el bombeo éxitoso es una habilidad que se aprende. No se desanime, y ciga trabajando en ello para obtener los mejores resultados. La leche materna se produce en una base de demanda; Sacando su leche materna estimula regularmente y mantiene su producción de ella.

Si sus senos se sienten incómodos o dolorosos durante el uso de la bomba, pruebe el reducir el nivel de aspiración girando la Rueda de Succión y ajuste hacia abajo (-). Usted también puede tratar de bombear con / sin el amortiguador de silicona. Si estos consejos no le ayudan, apague el producto y re8re la bomba de sus senos por unos minutos. Si usted todavía está experimentando dolor o malestar, consulte a su profesional de salud o un especialista en lactancia, certificado por un consejo internacional.

Sugerencias (Continúa)

Almacenamiento de la batería:

- Cuando guarde la pila durante un corto período de tiempo, guárdela con una temperatura entre -4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a 60 ° C).
- Cuando guarde la pila durante un período prolongado de tiempo, guárdela con una temperatura entre 32 ° F y 77 ° F (0 ° C a 25 ° C).

Sugerencias de la Lactancia Materna:

- La Doble Bomba de Leche Eléctrica Drive Medical le ayuda a mantener un suministro de leche y puede ayudarle a prepararse para los eventos planificados como "Citas" o acontecimientos inesperados, como los cortes de energía, tratamiento médico, o el alivio de los pezones sensibles.

Solución de problemas

Interrupción de Servicio Electrico	Si usted experimenta una interrupción del servicio eléctrico, debido a una subida de tensión u otros factores, durante el funcionamiento normal de su Doble Bomba Electrica de Leche Drive Medical, intente lo siguiente: ● Desconecte el cable del adaptador AC / DC del enchufe eléctrico y espere cinco segundos. ● Conecte el cable del adaptador AC / DC a un enchufe eléctrico. ● Si el problema persiste, pruebe con otro enchufe eléctrico.
La energía de radiofrecuencia	Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se ha instalado correctamente y utilizado según las instrucciones; puede causar interferencias perjudiciales con otros dispositivos cercanos. Pruebe lo siguiente: ● Reorientar o reubicar el dispositivo que recibe la interferencia. ● Aumente la distancia entre el equipo. ● Conectar el equipo a un enchufe de corriente en un circuito diferente del que los otros dispositivos) están conectados. ● Consulte con el fabricante o con un técnico de servicio de campo sobre el dispositivo que recibe la interferencia Para que le den ayuda. ● No hay ninguna garantia de que no se produscan interferencias.
Disminución de succión	Si se siente como la succión ha disminuido, intente lo siguiente: ● Asegúrese de que la bomba de pecho se ansambleada correctamente (consulte las páginas de Instrucciones pagina 8 a 13). ○ Inspeccione la válvula de un solo sentido para cualquier roturas o agujeros. Este componente es fundamental para lograr una absorción apropiada. Si está dañado, reemplace la válvula de una vía con una de las válvulas de repuesto que se proporcionan con La Doble Bomba de pecho Electrica de Drive Medical. ● Desconecte el tubo y el adaptador de tubo de la parte posterior de la bomba de pecho eléctrica y coloque un dedo sobre el tubo Adaptador de entrada. ○ Si usted siente la succión, la base de la bomba eléctrica funciona correctamente. ○ Si usted no siente la succión o siente que la succión se ha reducido a una fuerza inferior; contacte a el Servicio al cliente de Drive Medical para servicio de garantia (ver página 31).

Solución de problemas (Continuación)

No se tiene respuesta al poner en operación el botón de la Rueda de Ajuste y el botón de modo:	Usted NO puede ajustar el nivel de succión o cambiar entre la Extracción rápida y Extracción natural mientras se encuentra en "Mi Patrón Favorito".
La acumulación de leche materna en la copa de senos	Si la leche materna no parece drenar lo suficientemente rápido en la Colección de botella, reduzca el ajuste de succión en su extractor de leche eléctrico para permitir que la leche se drene antes de aumentar gradualmente.
Dónde obtener piezas de repuesto	Si le falta una pieza o una parte se ha dañado, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente de Drive Medical llamando al número gratuito (866) 694-5085. Puede adquirir accesorios adicionales para su Doble Bomba De Pecho Electronica Drive Medical por los siguientes métodos: ● Email: customerservice@drivemedical.com ● Fax: (516) 998-4601 ● Llamada- Gra8s: (866) 694-5085

Datos Técnicos

Requisitos del Poder Electrico:

- Adaptador de AC / DC (incluido) Configuración de Enchufe para Norte America:
  Marca: Acute Ideas
  Modelo:GDP12AV-1201000, 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz, 0.45A, adaptador de 8po de enchufe de pared de CA / CC con salida de 12V/1A DC.
- Las baterías:
  4 pilas AA; alcalinas de 1.5V

Especificaciones técnicas:

SUCCÍON:
Extracción de Reflejo o Rápida: -85~-185mmHg (-11.3~-24.6kpa)
Extracción Natural: -110~-250mmHg (-14.6~-33.3kpa)
Rango de temperatura ambiental:+10°C a 40°C (50°F a 104°F)
Rango de humedad relativa: 20% a 80%

Llave para cuadro de Símbolo:

- Equipo tipo BF (Copa de pecho)
- Consulte las instrucciones de uso
- La eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Hecho en China
Fabricado por Rumble Tuff®.

Bomba Manual de Seno - Guía Rápida de Referencia

Guía de piezas:

• Aditamento de diafragma manual

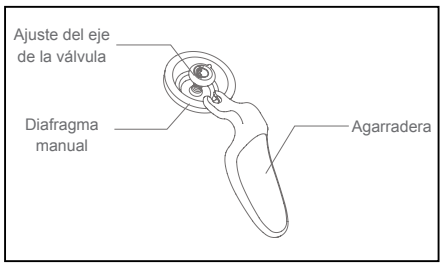

Nota:
1. Las piezas con "*" son específicas para la bomba manual para seno.
2. Las piezas específicas para la bomba manual para seno se incluyen en una bolsa separada:

* Ajuste del Eje de la Válvula (Válvula Ajustable + Eje de la Válvula)
** Agarradera
*** Diafragma manual

• Kit de Recolección de Extracción

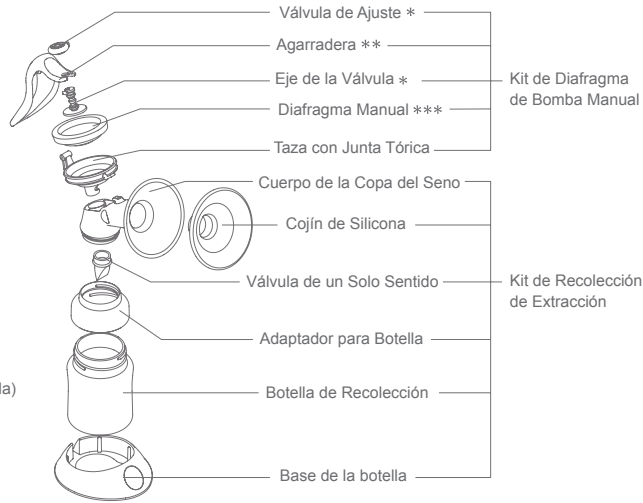
Válvula de Ajuste *
Agarradera **
Eje de la Válvula *
Diafragma Manual ***
Taza con Junta Tórica
Kit de Diafragma de Bomba Manual
Cuerpo de la Copa del Seno
Cojín de Silicona
Válvula de un Solo Sentido
Adaptador para Botella
Botella de Recolección
Base de la botella
Kit de Recolección de Extracción

Bomba Manual de Seno - Guía Rápida de Referencia (continuación)

Cómo Ensamblar el Kit del Combo de Recolección de Extracción:
Su bomba manual para seno Drive Medica viene preensamblada, sin embargo, tendrá que volver a armarla después de cada. (Para ver instrucciones de limpieza, consulte el Manual de instrucciones y armado). A continuación incluimos una guía paso por paso para armar el kit combo de recolección de extracción:

	1. Sujete el "cuerno" del cuerpo de la copa del seno con una mano. Asegúrese de que el extremo con la rosca de la botella apunte hacia arriba.
	2. Con el dedo pulgar e índice de la otra mano, sujete la punta de la válvula de un solo sentido y coloque el fondo circular plano dentro de la abertura. Asegúrese de no estrechar, doblar o torcer la punta de la válvula de un solo sentido. Selle todas las orillas del fondo circular plano firmemente. ***Nota**: La punta de la válvula de un solo sentido no se tiene que alinear con nada, siempre y cuando todas las orillas estén selladas de forma segura.*

Bomba Manual de Seno - Guía Rápida de Referencia (continuación)

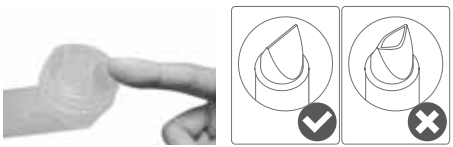	3. Con su pulgar e índice, cierre suavemente cualquier abertura sobre la punta de la válvula de un solo sentido y dele una forma en línea recta. ***Nota**: Esto es un punto crítico para el rendimiento óptimo de la bomba.*
	4. Gire cuidadosamente sobre el adaptador de la botella en el cuerpo de la copa del seno para que ajuste de forma segura. ***Nota**: Asegúrese de no golpear la válvula de un solo sentido al atornillar y juntar el cuerpo de la copa del seno y el adaptador.*
	5. Con el adaptador de botella en una mano, gire sobre la botella de recolección para que se ajuste de forma segura.

Bomba Manual de Seno - Guía Rápida de Referencia (continuación)

Cómo ensamblar el kit del diagrama de la bomba manual:

	1. Con la copa en una mano, coloque el diagrama manual de silicona dentro de la copa (para que coincida con la forma de la copa). Oprima alrededor de las orillas del diafragma para que se ajuste de forma segura. Asegúrese de que el diafragma esté montado uniformemente sobre la copa y que no existan huecos entre los mismos.
 Gire hacia la derecha 	2. Gire el kit del diafragma de la bomba manual hacia la derecha dentro de la unidad del cuerpo de la copa del seno hasta que se bloquee en su lugar.

Bomba Manual de Seno - Guía Rápida de Referencia (continuación)

	3. Coloque la ranura en forma de "U" de la agarradera sobre el empotrado del eje de la válvula ajustable. (Existen 2 empotrados sobre el eje de la válvula ajustable. El empotrado superior reproduce la configuración de la extracción rápida y el empotrado inferior reproduce la configuración de extracción natural de la bomba eléctrica Drive Medical.)
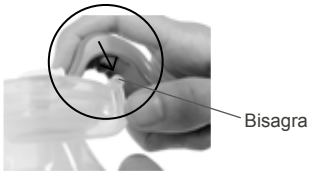	4. Oprima la agarradera hacia abajo sobre la bisagra de la taza hasta que se "enganche" en su lugar.
	5. Con el cuerpo de la copa del seno en una mano, coloque el cojín de silicona en el cuerpo de la copa del seno (coincidiendo con la forma del cuerno). Asegure el labio del cojín alrededor de las orillas del cuerno. Su bomba manual para seno funcionará con o sin el cojín de silicona. Su comodidad depende de sus gustos.

Bomba Manual de Seno - Guía Rápida de Referencia (continuación)

Cómo usar la bomba manual:

Nota: Existen dos empotrados para fijar la agarradera de la bomba manual. Usted puede alternar entre estas dos configuraciones al presionar y alejar el eje de la válvula ajustable de la punta en forma de "U" de la agarradera para dislocar la conexión. Vuelva a sujetar la punta de la agarradera usando un empotrado diferente en el eje de la válvula ajustable.

Configuración de Extracción Rápida:
Esta configuración es para una succión rápida y superficial. Con frecuencia, cuando un bebé tiene hambre o simplemente se "ha colgado", su patrón de lactancia es rápido y superficial para iniciar el flujo de leche de la madre.

Configuración de Extracción Natural:
Esta configuración es para una succión más larga y profunda. Cuando la leche de la madre empieza a fluir dentro de la boca del bebé (bajar), y con frecuencia se cambian naturalmente a un patrón de succión más largo y profundo.

1. Coloque la bomba manual de seno en su seno de manera que su pezón esté centrado dentro de la copa del seno. Luego apriete la agarradera hacia la botella para probar la succión.

Nota: *Luego apriete la agarradera hacia la botella para probar la succión.*

Aumentar

Disminuir

2. Usted puede ajustar el nivel de succión al girar la perilla redonda sobre la parte superior del eje de la válvula de ajuste. Gire hacia la derecha para aumentar la succión y hacia la izquierda para disminuirla.

Nota: *No volcar la válvula de ajuste, ya que esto ocasionará que la válvula de ajuste sobresalga y fugue aire, generando un problema de succión. Asegúrese que el espacio de abertura en la parte superior de la válvula de ajuste esté alineada adecuadamente con la parte superior del eje de la válvula a manera que la válvula gire suavemente. De ser necesario, vuelva a ajustar la válvula de ajuste al girarla hacia atrás y hacia adelante varias veces.*

Bomba Manual de Seno - Guía Rápida de Referencia (continuación)

Solución de problemas:

- **Vacío Insuficiente**

	• Centre su pezón dentro de la copa del seno. Asegúrese de sellar completamente la copa del seno, asegurándose que no existan espacios entre el seno y al copa del seno.
	• Verifique que la agarradera esté "enganchada" en su lugar contra el eje de la válvula. • Revise el nivel de succión girando la válvula de ajuste.
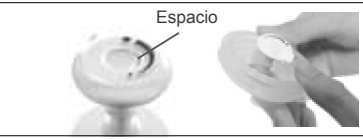	• Asegúrese que el espacio de abertura en la parte superior de la válvula de ajuste esté alineada adecuadamente con la parte superior del eje de la válvula a manera que la válvula gire suavemente. De ser necesario, vuelva a ajustar la válvula de ajuste al girarla hacia atrás y hacia adelante varias veces. • Asegúrese de que el diafragma manual esté sellado adecuadamente y que no haya espacios entre el diafragma y la taza.
	• Revise el anillo "O" para asegurar que esté sentado sobre la ranura. • Asegúrese que el kit del diafragma de la bomba manual esté bloqueado en su lugar sobre el kit de recolección de extracción.
	• Verifique que la punta de la válvula de un solo sentido está sentada de forma segura y sellada adecuadamente. 

Garantía

Garantía Limitada del consumidor para el Producto (Estados Unidos)
Este Drive Medical Extractor de Leche Eléctrico garantizado para el consumidor original "comprador" de estar libre de defectos en materiales y mano de obra, que no son comercialmente aceptable, para el período de 120 días a par8r de la fecha de compra y una garantia extendida de un año en el motor de la bomba. Esta garan{a se aplica únicamente al propietario original. La cobertura de la garantia se termina si usted vende o transfiere este producto a otra persona de otra manera. Esta garantia le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían según la ubicación

DRIVE MEDICAL NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESADA DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO EXCEPTO LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE UN PERÍODO DE 120 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA POR EL COMPRADOR ORIGINAL.

En el caso de que este producto se encuentra por Drive Medical de no cumplir con la norma de garantia limitada, como único y exclusivo recurso del comprador, Drive Medical reparará o, a opción del Drive Medical, reemplazará este producto sin cargo alguno por tales piezas de recambio o mano de obra . El comprador se hará cargo de todos los gastos relacionados con la vuelta de este producto para Drive Medical. Esta garantia no se aplica a cualquier parte del producto que ha sido objeto de mal uso, abuso o alteración. Se recomiendan piezas de repuesto de la marca Drive Medical para su uso con productos para la lactancia. Inapropiado o incorrecto mantenimiento o reparación, o el uso de piezas de repuestos que no son de Drive Medical anula esta garantía.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, Drive Medical NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LOS COSTOS DE REEMPLAZO QUE RESULTEN DE DAÑOS O EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA POR ESCRITO O IMPLÍCITA.

Garanca (Continuación)

Si usted desea hacer un reclamo bajo esta garantía, usted necesitará lo siguiente:

- El producto original completo de Drive Medical
- El recibo Original que muestre la fecha de compra
- número de autorización de retorno (RA #)
- Descripción detallada del problema

Usted, como comprador, es responsable de todos los gastos de envío. NO ENVIE el producto sin un RA #.
Para obtener un RA # y dirección de envío: comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente Drive Medical;
Línea telefónica gratuita (866) 694-5085, o
correo electrónico a customerservice@drivemedical.com, o

Al escribir a:
Departamento de Servicio al Cliente
Drive Medical Design & Manufacturing
99 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11050

Los artículos devueltos sin un RA # no serán procesados y serán devuelto salremitente (a Franqueo debidos).

99 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11050
Tel: (866) 694-5085 | Fax: (516) 998-4601

www.drivemedical.com